

Dessa instruktioner visar hur man uppdaterar sitt Tandem Mobi System med nya funktioner.

⚑ **Obs:** Dessa instruktioner är avsedda som ett referensverktyg för pumpanvändare och vårdnadshavare som redan är bekanta med användning av insulinpump och med insulinbehandling i allmänhet. Alla skärmbilder visas inte. För mer detaljerad information om hur Tandem Mobi-systemet används, se dess bruksanvisning.

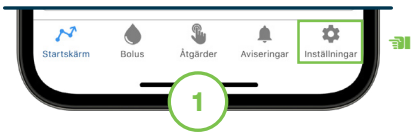

I navigeringsfältet trycker du på **Inställningar** och därefter på **Pump**.

⚑ **Obs:** Systemet använder enhetsautentisering för att säkerställa datasäkerhet och patientsekretess.

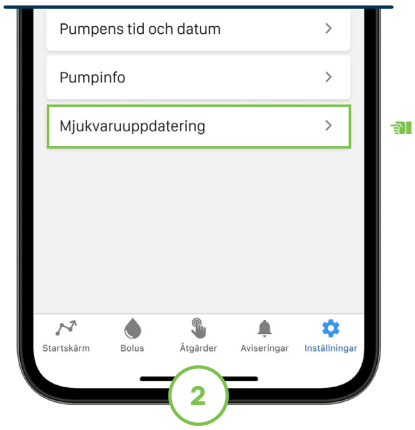


Tryck på **Mjukvaruuppdatering**.

Skärmen **Mjukvaruuppdatering tillgänglig** visas för att bekräfta att en uppdatering är tillgänglig.




Om de första stegen på denna skärm redan genomförts, gå till steg 4. Annars tryck på **Gå till Tandem Source** för att genomföra dem.

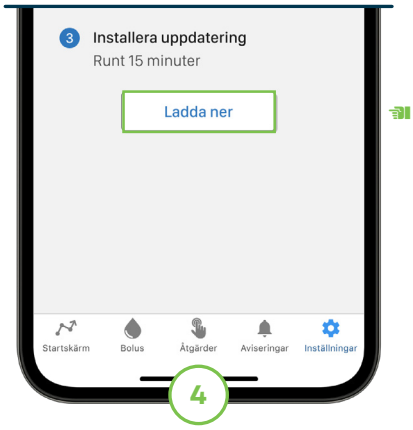

Tryck på **Ladda ner**.

Mobilappen kommer att börja ladda ner pumpens mjukvaruuppdatering.

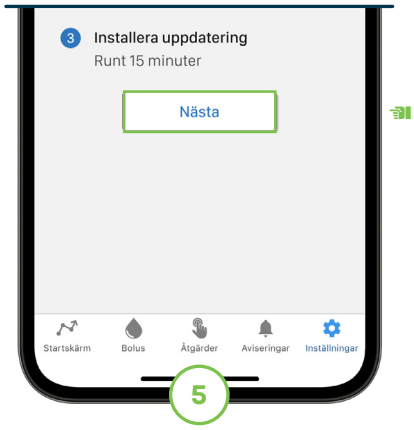

Tryck på **Nästa** för att fortsätta när nedladdningen av uppdateringen är klar.



Tryck på cirkeln bredvid varje säkerhetssteg för att bekräfta instruktionerna.
Tryck på **Nästa** för att fortsätta.




En skärm för **Stoppa insulin** visas. Om insulindoseringen redan stoppats, gå till steg 10. Annars, tryck på **Åtgärder** i navigeringsfältet och sedan på **Stoppa insulin**.



Tryck på **Ja** för att bekräfta att insulindoseringen kommer att stoppas.

⚠ **Varning:** Koppla bort infusionssetet från kroppen.

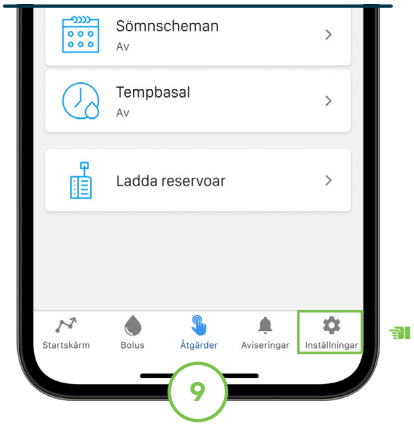

I navigeringsfältet, tryck på **Inställningar** och navigera enligt steg 1 och 2 för att återgå till mjukvaruuppdateringen.



Tryck på **Nästa** för att fortsätta.

På nästa skärm, tryck på **Installera** och sedan på **Inst. och starta om**.



Mjukvaruuppdateringen startar. Håll pumpen nära smartphonen under processen.



När mjukvaruuppdateringen är klar, tryck på **Avvisa**.

⚑ **Obs:** Reservoaren måste bytas innan insulindoseringen kan återupptas.

Tryck på **Ladda reservoar** på skärmen för att göra detta nu, eller tryck på **Gå till startskärmen** för att göra det senare.

Pumptips: Om det fanns en aktiv sensorsession innan uppdateringsprocessen startade, måste den återupptas.



www.tandemdiabetes.com/safetyinfo

© 2026 Tandem Diabetes Care, Inc. Alla rättigheter förbehålles. Tandem Diabetes Care, Tandem logotyper, Tandem Mobi och Tandem Source är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Tandem Diabetes Care, Inc. i USA och/eller andra länder. Alla andra varumärken från tredje part tillhör deras respektive ägare. SE-2447-260223